Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Ohne Genehmigung ist es verboten, dieses Dokument zu kopieren oder weiterzugeben.
DRÄGERWERK AG Lübeck

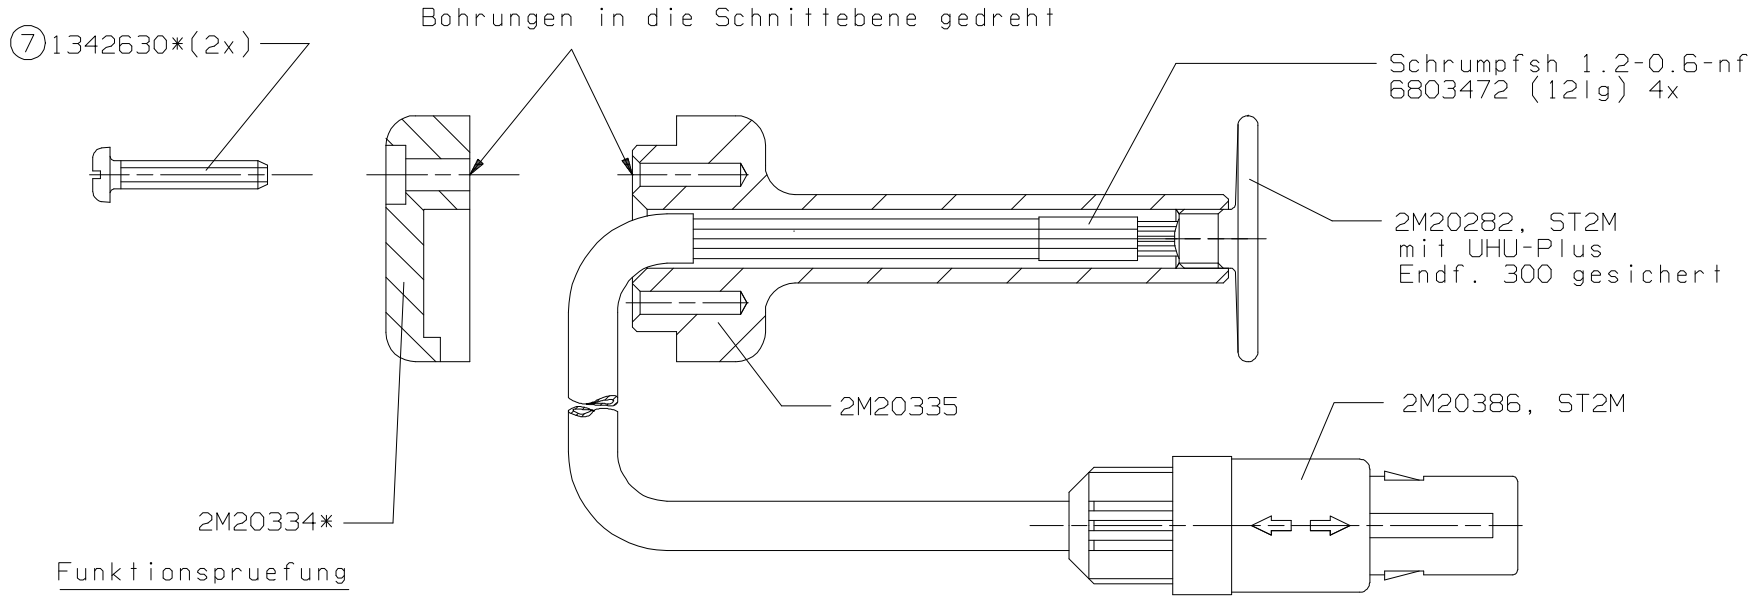

Funktionspruefung

-Messung des Widerstandswertes zwischen Steckerbuchsen 1+2, sowie zwischen 4+5
-Widerstandswert ablesen und nach unterstehender Tabelle den Temperaturwert ermitteln.
-Vergleich des ermittelten Temperaturwertes mit der Raumtemperatur. Zulaessige Abweichung:±1°C.

T (°C)	R(Ω)	T (°C)	R(Ω)
15	7854,70	23	5460,90
16	7498,50	24	5224,70
17	7160,50	25	5000,00
18	6839,70	26	4786,10
19	6535,20	27	4582,50
20	6246,00	28	4388,80
21	5970,80	29	4204,40
22	5709,40	30	4028,70

Isolationspruefung 200 V DC

Die Pruefspannung ist anzulegen zwischen den Steckerpins 1 und 4
1 und 3
4 und 3

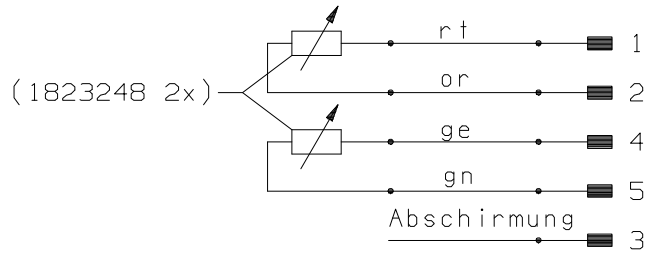

* Lose Teile

verpackt in Flachbeutel mind. 200x240 DWN 1210

ST2M20277

=QA= --	=QB= --	=QC= --				
Werkstoff ---			07	1x	DIN Teil geaendert 11.06.97/Sti.	
					(37/97)	
			Aend. Ziffer	kommt vor	Aenderungen	
Maszstab 2:1	Allgemeintoleranzen ---	Abteilung M2	1994	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger
			Bearb	27.10.	OLLMANN	
			Gepr.	27.10.	OLLMANN	
				--	--	
PROD	CADRA=8	Benennung Sensor, vollst.			Zeichnungs-Nr. 2M20277	
					Ersatz fuer 2M20277-06	
					Ersetzt durch	

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of this document / content is forbidden
without express authority. All rights reserved.
D R Ä G E R W E R K A.G. Lübeck

STEUERLTG GR ABG 6x0.14
LV00195
(1700^{*10} LG) ⑥



MANTEL UM 35MM
ABGELAENGT;
ABSCHIRMUNG,SW,BR BIS
MANTEL ABGELAENGT

1831275
SCHRUMPFSH
2.4-1.2X0.51-RT102
(12LG)
(FUER ABSCHIRMUNG),
SCHRUMPFSH
1.2-0.6-NF 6803472
(7LG)4X

ADERENDEN 4±1 ABISOLIERT UND VERZINNT

ANSICHT RICHTUNG
LOETSTUETZPUNKTE

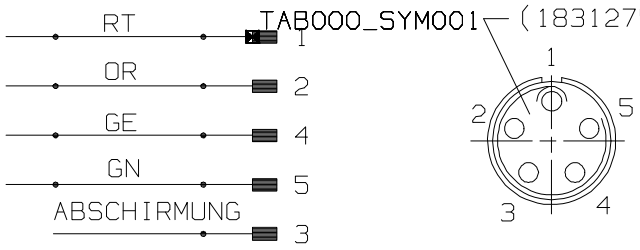

ST 2M20386

=QA= --	=QB= --	=QC= --					
Werkstoff ---			6	1X	KABELLAENGE GEAEND.		
			Aend. Ziffer	kommt vor	Aenderungen		
Maszstab 1 : 1	Allgemeintoleranzen ---	Abteilung M2	1992	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger	
			Bearb	03. 08.	OLLMANN		
			Gepr.				
INFO	CADRA	Benennung Kabel				Zeichnungs-Nr. 2M20386	
						Ersatz fuer 2M20386"5"	
						Ersetzt durch	